

ILNAS

Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services


ILNAS-EN ISO 80601-2-12:2011/ AC:2011

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-12: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von

Medical electrical equipment - Part 2-12:
Particular requirements for basic safety
and essential performance of critical care
ventilators - Technical Corrigendum 1

Appareils électromédicaux - Partie 2-12:
Exigences particulières relatives à la
sécurité de base et aux performances
essentielles des ventilateurs pulmonaires

10/2011

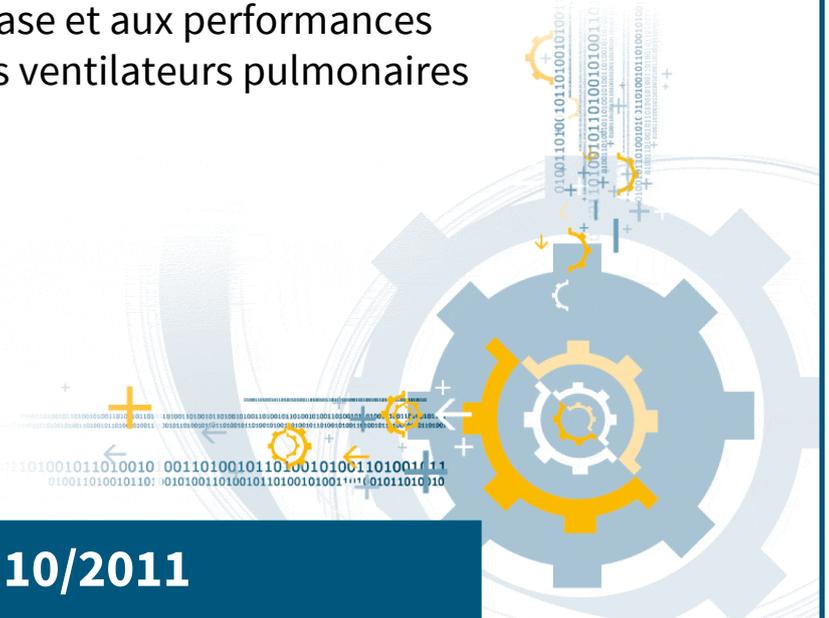

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 80601-2-12:2011/AC:2011 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN ISO 80601-2-12:2011/AC:2011 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Künftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

<https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html>

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!

ICS 11.040.10

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators - Technical Corrigendum 1 (ISO 80601-2-12:2011/Cor 1:2011)

Appareils électromédicaux - Partie 2-12:
Exigences particulières relatives à la
sécurité de base et aux performances
essentielle des ventilateurs pulmonaires
pour utilisation en soins intensifs -
Rectificatif technique 1 (ISO 80601-2-
12:2011/Cor 1:2011)

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-12:
Besondere Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Beatmungsgeräten
für die Intensivpflege (ISO 80601-2-
12:2011/Cor 1:2011)

This corrigendum becomes effective on 15 October 2011 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 15 octobre 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 15. Oktober 2011 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels